



ООО Центр Метрологии «СТП»
Регистрационный номер записи в реестре аккредитованных
лиц RA.RU.311229

«УТВЕРЖДАЮ»

Технический директор
ООО Центр Метрологии «СТП»
И.А. Яценко

2018 г.



Государственная система обеспечения единства измерений

КОРРЕКТОРЫ ГАЗА ПОТОКОВЫЕ ЕК280, ЕК290

МЕТОДИКА ПОВЕРКИ

(с изменением №2)

ЛГТИ.407229.280 МП

Настоящая методика распространяется на корректоры газа потоковые ЕК280, ЕК290 (далее – корректор) с номером версии программного обеспечения 1.10, а также выпущенные ранее и прошедшие модернизацию в соответствии с ЛГТИ.407229.280 РДР «Корректоры газа потоковые ЕК280, ЕК290. Руководство по диагностике и ремонту», и устанавливает методику их первичной и периодической поверок.

(Измененная редакция, Изм. № 2)

Корректоры газа потоковые ЕК280, ЕК290 предназначены для измерения давления, перепада давления, температуры, импульсных или цифровых сигналов от расходомеров и счетчиков газа объемных и приведения объема газа (попутного, свободного нефтяного, факельного, природного и других неагрессивных, сухих газов, в том числе аргон, азот, воздух) к стандартным условиям по ГОСТ 2939–63.

Интервал между поверками – 5 лет.

1 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

Операции поверки корректора приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Операции поверки

Операция	Номера пунктов методики поверки	Обязательность выполнения операций при поверке	
		Первичной	Периодической
1 Внешний осмотр	6.1	да	да
2 Проверка идентификации программного обеспечения.	6.2	да	да
3 Опробование и проверка на отсутствие потерь счетных импульсов	6.3	да	да
4 Определение метрологических характеристик	6.4	да	да
4.1 Определение относительной погрешности при измерении абсолютного давления*	6.4.1	да	да
4.2 Определение основной приведенной погрешности при измерении избыточного давления	6.4.2	Да (при наличии)	Да (при наличии)
4.3 Определение основной приведенной погрешности при измерении перепада давления	6.4.3	да (при наличии)	да (при наличии)
4.4 Определение относительной погрешности при измерении температуры	6.4.4	да	да
4.5 Определение относительной погрешности при приведении объема газа, к стандартным условиям, в диапазоне изменения параметров газа, с учетом погрешности измерения давления, температуры и вычисления коэффициента сжимаемости	6.4.5	да	да
Примечание – определение погрешностей при измерении давления, перепада давления и температуры проводят для подключенных измерительных каналов.			

2 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

2.1 При проведении поверки применяют средства поверки, указанные в таблице 2.

Таблица 2 – средства поверки

Средство поверки	Номера пунктов методики поверки	Основные технические характеристики средства поверки
1 Калибратор давления DPI 620	6.4.1, 6.4.2, 6.4.3, 6.4.5	Диапазон измерения абсолютного/избыточного давления должен соответствовать диапазону поверяемого преобразователя, пределы основной приведенной погрешности $\pm 0,05\%$.
2. Измеритель температуры многоканальный прецизионный МИТ8.10	6.4.4, 6.4.5	Диапазон измерения от -200°C до $+125^{\circ}\text{C}$, пределы абсолютной погрешности $\pm(0,003+10^{-5}t)^{\circ}\text{C}$
3 Термометр сопротивления платиновый выборочный эталонный ПТСВ-5-3	6.4.4, 6.4.5	Диапазон измерения от -50°C до $+250^{\circ}\text{C}$ с пределами абсолютной погрешности $\pm 0,03^{\circ}\text{C}$
4 Термостат LAUDA RE1050	6.4.4, 6.4.5	Воспроизведение температур от -50°C до $+150^{\circ}\text{C}$
5 Частотомер электронно-счетный ЧЗ-85/5	6.3	Погрешность счета не более ± 1 импульс
6 Генератор сигналов специальной формы AWG-4105	6.3	Диапазон воспроизведения импульсного сигнала частотой от 10 мГц до 5 МГц
7 Барометр анероид контрольный М-67	6.4	Диапазон измерения от 610 до 790 мм рт.ст., пределы абсолютной погрешности после введения поправок $\pm 0,8$ мм рт.ст.
8 Гигрометр психрометрический ВИТ-1	6.4	Диапазон измерения температуры от 0°C до 25°C , цена деления $0,2^{\circ}\text{C}$; диапазон измерения относительной влажности от 20 % до 90 %

2.2 Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик поверяемых корректоров с требуемой точностью.

(Измененная редакция, Изм. № 2)

3 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

3.1 При проведении поверки соблюдаются следующие требования безопасности:

– правила безопасности труда, действующие на предприятии;

– правила безопасности при эксплуатации используемых средств поверки, приведенные в их эксплуатационных документах;

– правила пожарной безопасности, действующими на предприятии.

3.2 Надписи и условные знаки, выполненные для обеспечения безопасной эксплуатации корректора должны быть четкими.

3.3 Доступ к средствам измерений и обслуживаемому при поверке корректора оборудованию должен быть свободным.

3.4 Рабочее давление применяемых средств поверки, указанное в эксплуатационной документации, должно быть больше того, которое может иметь место при поверке.

(Измененная редакция, Изм.№1)

3.5 К поверке допускаются лица, имеющие квалификационную группу по технике безопасности не ниже II в соответствии с «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», изучивших эксплуатационную документацию и настоящий документ.

4 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

4.1 При проведении поверки соблюдаются следующие условия:

- температура окружающего воздуха, °C 20 ± 5

- относительная влажность воздуха, % 60 ± 30

- атмосферное давление, кПа $84\dots 106,7$

5 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

5.1 Подготавливают все средства поверки и корректор к работе:

5.1.1 Устанавливают и подготавливают к работе средства поверки, перечисленные в п. 2.1 настоящего документа, в соответствии с требованиями эксплуатационной документации на указанные средства.

5.1.2 Устанавливают корректор на лабораторном столе.

5.1.3 Соединяют шланг подачи давления с датчиком давления корректора.

5.1.4 Соединяют шланг подачи давления с датчиком перепада давления корректора.

5.1.5 Помещают датчики температуры в термостат.

5.1.6 Подключают генератор импульсов к корректору.

6 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

6.1 Внешний осмотр

При периодической поверке и первичной после ремонта убедиться в отсутствии наружных повреждений, влияющих на работу корректора.

Проверяют комплектность корректора согласно ЛГТИ.407229.280 ПС, ЛГТИ.407229.290 ПС. У корректоров, выпущенных до 1 января 2018 года, проверяют

наличие приложения к ЛГТИ.407229.280 ПС или ЛГТИ.407229.290 ПС с отметкой о проведении модернизации.

При первичной поверке при выпуске из производства проверяют целостность пломбировки, покрытий и окраски, убеждаются в отсутствии наружных повреждений. Не допускается наличие на корпусе трещин, сколов и других дефектов, влияющих на работу корректора.

Проверяют наличие маркировки корректора путем сличения с маркировкой, указанной в ЛГТИ.407229.280 РЭ, ЛГТИ.407229.290 РЭ.

(Измененная редакция, Изм. № 2)

6.2 Проверка идентификации программного обеспечения

Определение идентификационного наименования и контрольной суммы метрологической части ПО:

С помощью клавиатуры или через интерфейс проверить номер версии метрологически значимой части программного обеспечения и контрольной суммы исполняемого кода метрологически значимой части.

Номер версии метрологически значимой части программного обеспечения отображается корректором в меню «Система» пункт меню – «ВЕРСМ».

Результат расчета цифрового идентификатора ПО (контрольной суммы исполняемого кода метрологически значимой части) встроенного ПО корректора выводится в меню сведений о приборе «Система» пункт меню «ТЕСТМ».

Номер версии и контрольная сумма ПО должны соответствовать, указанным в описании типа или в паспорте на корректор.

(Измененная редакция, Изм. № 2)

6.3 Опробование и проверка на отсутствие потерь счетных импульсов

6.3.1 При опробовании проверяют срабатывание клавиатуры корректора и наличие индикации на жидкокристаллическом дисплее.

6.3.2 При поверке проверяют все исходные данные, занесенные в память корректора, указанные в паспорте. Дополнительно, при поверке в составе измерительного комплекса, измеряющего объем газа с коррекцией по давлению, температуре проверяют коэффициент преобразования импульсов Ср. Он должен соответствовать коэффициенту преобразования счетчика газа.

6.3.3 Проверка на отсутствие потерь счетных импульсов НЧ/ВЧ входа.

Для проверки счетных импульсов НЧ/ВЧ¹ входа необходимо собрать схему согласно рисунку 1, либо использовать счетчик газа.

Допускается применение приборов, в которых совмещены функции генератора импульсов и счетчика импульсов.

¹ Для проверки ВЧ входа к корректору ЕК280, ЕК290 необходимо подключить внешний источник питания

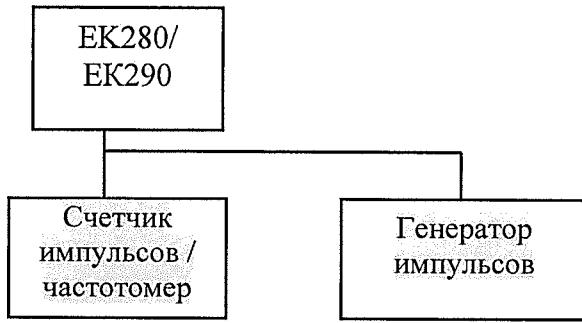


Рисунок 1

Проводят проверку работы корректора при измерении объема газа без коррекции по формуле

$$V = \frac{N}{C_p}, \quad (1)$$

где N – число импульсов, приходящих на корректор от счетчика газа;
 C_p – коэффициент преобразования счетчика газа, имп/м³

Устанавливают на корректоре коэффициент преобразования C_p счетчика газа, имп/м³:

$C_p = 1$, если корректор поставляется самостоятельно;

C_p – равное коэффициенту преобразования соответствующего счетчика газа, с которым работает корректор.

Для проверки НЧ входа переводят входы DE1 и DE3 (DE3 только для корректора EK290) в режим «Импульсный вход», с генератора подают 20 импульсов при $C_p > 1$ или 5 импульсов при $C_p \leq 1$ поочередно на входы корректора DE1 и DE3 (только для корректора EK290). Операцию повторяют два раза.

Для проверки ВЧ входа переводят входы DE1 и DE3 (DE3 только для корректора EK290) в режим «ВЧ.вход», с генератора подают серию импульсов частотой 500 Гц длительностью не менее 5 секунд поочередно на входы корректора DE1 и DE3 (DE3 только для корректора EK290). Операцию повторяют два раза.

Во всех случаях значение объема V , м³, вычисленное корректором должно точно соответствовать расчетному, с учетом округления до значения цены деления младшего разряда. В процессе опробования не должно происходить потери импульсов.

При использовании счетчика газа в качестве генератора импульсов, соединить датчик импульсов корректора со счетчиком, зафиксировать показания счетчика, пропустить через счетчик объем воздуха (газа) достаточный для не менее, чем 5 полных оборотов последнего колеса счетного механизма счетчика газа, зафиксировать показания счетчика. Число импульсов N (имп), переданных на корректор, равно приращению показаний счетчика после проверки (без учета значений младшего разряда механического отсчетного устройства) (м³), деленного на цену одного импульса счетчика газа (м³/имп).

Приращение рабочего объема на корректоре должно точно соответствовать объему, полученному по вышеприведенной формуле (1).

(Измененная редакция, Изм. № 2)

6.4 Определение метрологических характеристик

6.4.1 Определение относительной погрешности при измерении абсолютного давления

6.4.1.1 Определение относительной погрешности при измерении давления производят в пяти точках, равномерно распределенных по всему диапазону измерения, указанному в паспорте, включая крайние точки. ($P=P_1\dots P_5$).

6.4.1.2 Подключают калибратор давления ко входу преобразователя абсолютного давления корректора согласно схемы, указанной на рисунке 2.

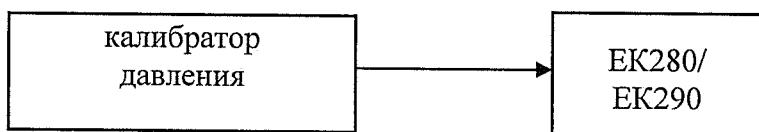


Рисунок 2

6.4.1.3 В ходе проверки давление в каждой точке задают с отклонением не более $\pm 1\%$. В каждой точке $P_1\dots P_5$ производят по одному измерению при прямом и обратном ходе и вычисляют относительную погрешность по формуле:

$$\delta_p = \frac{P - P_3}{P_3} \cdot 100\%, \quad (2)$$

где P – значение давления, измеренное корректором, МПа;
 P_3 – значение давления, измеренное калибратором давления, МПа;

6.4.1.4 Результат поверки считают положительным, если при каждом измерении относительная погрешность не превысила $0,35\%$.

6.4.2 Определение приведенной погрешности при измерении избыточного давления

6.4.2.1 Определение приведенной погрешности при измерении избыточного давления производят в пяти точках, равномерно распределенных по всему диапазону измерения, указанному в паспорте, включая крайние точки. ($P=P_1\dots P_5$).

6.4.2.2 Подключают калибратор давления ко входу преобразователя избыточного давления корректора согласно схемы, указанной на рисунке 3.

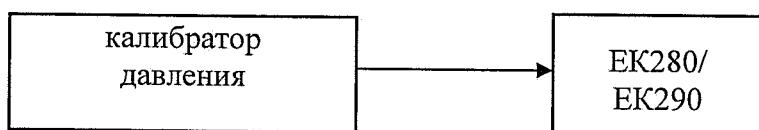


Рисунок 3

6.4.2.3 В ходе проверки давление в каждой точке задают с отклонением не более $\pm 1\%$. В каждой точке $P_1\dots P_5$ производят по одному измерению при прямом и обратном ходе и вычисляют приведенную погрешность по формуле:

$$\gamma_p = \frac{P - P_3}{P_{\max}} \cdot 100\% \quad (3)$$

где P – значение избыточного давления, измеренное корректором, МПа;
 P_3 – значение избыточного давления, измеренное калибратором давления, МПа;
 P_{\max} – верхний предел измерения избыточного давления корректором, МПа.

6.4.2.4 Результат поверки считают положительным, если при каждом измерении приведенная погрешность не превысила 0,15%, 0,25%, 0,5% (в зависимости от характеристик подключенного преобразователя избыточного давления).

6.4.3 Определение основной приведенной погрешности при измерении перепада давления.

6.4.3.1 Измерения производят в трех точках: P_{\max} , $P_{\max}/2$, $P_{\max}/10$, где P_{\max} – верхний предел диапазона измерения перепада давления, приведенный в паспорте.

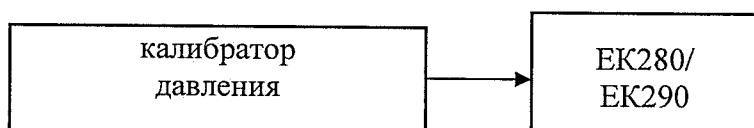


Рисунок 4

6.4.3.2 Перед проведением поверки проводят контроль «нуля» и при необходимости «коррекцию нуля» следующим образом:

- Открывают замок поставщика газа.
- С помощью вентильного блока выравнивают давление в обеих камерах датчика перепада давления:
 - открывают уравнительный вентиль;
 - закрывают вентиль, маркованный «–»;
 - закрывают вентиль, маркованный «+»;
 - выдерживают 1-2 минуты.

б) В случае, если значение перепада давления не равно нулю, то проводят корректировку нуля.

г) Корректировку нуля проводят вводом корректирующего значения, равного перепаду давления на счетчике с обратным знаком в меню “Давление”, подменю “дР” пункт “дРКор”. После ввода корректирующего значения контролируют повторно значение “дРТек”.

6.4.3.3 Подключают вход «плюс» преобразователя перепада давления корректора к калибратору давления.

6.4.3.4 Убеждаются в правильности установки в корректоре диапазона измеряемых перепадов давлений.

6.4.3.5 С помощью калибратора давления устанавливают давление равное P_{\max} с отклонением от заданного не более $\pm 1 \%$.

6.4.3.6 Вычисляют основную приведенную погрешность измерения перепада давления по следующей формуле:

$$\gamma_p = \frac{P - P_3}{P_{\max}} \cdot 100 \%, \quad (4)$$

- где P – значение перепада давления, измеренное корректором, кПа;
 P_3 – значение перепада давления, измеренное калибратором давления, кПа;
 P_{\max} – верхний предел измерения перепада давления корректором, кПа.

6.4.3.7 Повторяют шаги 6.4.3.5 – 6.4.3.6 для следующих точек диапазона измерения перепада давления: $P_{\max}/2$, $P_{\max}/10$, $P_{\max}/2$, P_{\max} .

6.4.3.8 Результаты поверки считаются положительными, если при каждом измерении основная приведенная погрешность при измерении перепада давления не превышает $\pm 0,1\%$.

6.4.4 Определение относительной погрешности при измерении температуры.

6.4.4.1 Определение относительной погрешности производят в трех точках $T_1=243,15$ К, $T_2=293,15$ К, $T_3=333,15$ К или $T_1=233,15$ К, $T_2=293,15$ К, $T_3=343,15$ К в зависимости от диапазона измерения, указанного в паспорте, согласно схемы, представленной на рисунке 5.

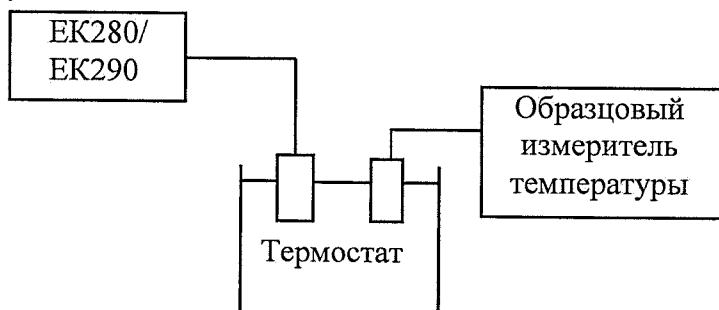


Рисунок 5

6.4.4.2 Температуру задают с отклонением не более ± 1 К. Время выдержки термопреобразователя сопротивления в каждой точке должно составлять не менее 1 мин.

В каждой точке производят по одному измерению и вычисляют относительную погрешность измерений температуры δ_T по формуле

$$\delta_T = \frac{T - T_3}{T_3} \cdot 100\% \quad (5)$$

где T_3 – значение температуры, измеренное образцовым термометром, К;
 T – значение температуры, измеренное корректором, К.

(Измененная редакция, Изм. № 2)

6.4.4.3 Результат поверки считают положительным, если при каждом измерении относительная погрешность при измерении температуры не превышает $\pm 0,1\%$.

6.4.5 Определение относительной погрешности при приведении объёма газа, к стандартным условиям, в диапазоне изменения параметров газа, с учетом погрешности измерения давления, температуры и вычисления коэффициента сжимаемости

6.4.5.1 Для определения погрешности используют схему, представленную на рисунке 6.

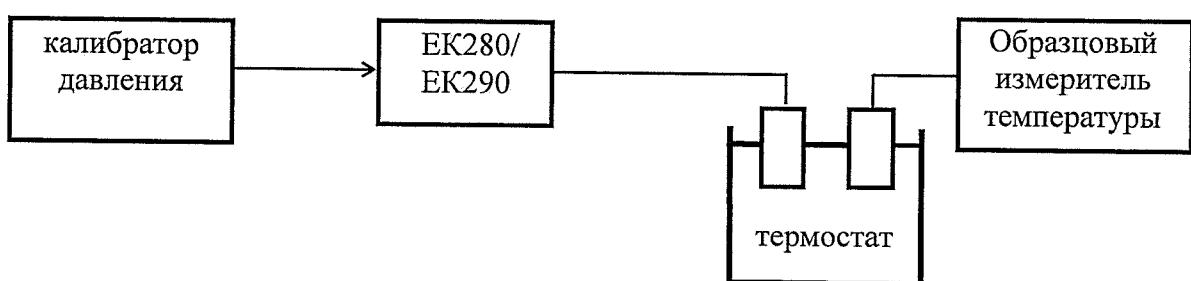


Рисунок 6

6.4.5.2 Преобразователь давления корректора подключают к калибратору давления, а преобразователь температуры корректора опускают в термостат.

6.4.5.3 С клавиатуры корректора вводят исходные данные, в соответствии с применяемым методом расчета коэффициента сжимаемости. Исходные данные приведены в таблицах 3-5. Для корректора ЕК290 определение относительной погрешность при приведении объема газа к стандартным условиям проводят отдельно для каждого канала. Для этого устанавливают значение параметра ПГДК2 (3:1А3) равным 2. Исходные данные параметров газа при этом вводятся индивидуально для каждого канала.

(Изменённая редакция, Изм. № 2)

Таблица 3 – исходные данные для метода по ГОСТ 30319.2-2015

№	Параметр	Показатели	Единицы измерения
1	CO ₂	0	моль, %
2	N ₂	0,65	моль, %
3	Плотность при стандартных условиях	0,6714	кг/м ³

(Измененная редакция, Изм.№ 1)

Таблица 4 – исходные данные для метода по ГСССД МР 113

№	Параметр	Показатели	Единицы измерения
1.1	Метан	72,5	моль, %
1.2.	Этан	14,3	моль, %
1.3.	Пропан	7,53	моль, %
1.4.	И-бутан	0,85	моль, %
1.5.	Н-бутан	1,57	моль, %
1.6.	И-пентан	0,29	моль, %
1.7.	Н-пентан	0,25	моль, %
1.8.	Гексан	0,12	моль, %
1.9.	Гептан	0,02	моль, %
1.11.	Азот	0,93	моль, %
1.12.	Диоксид углерода	1,56	моль, %
1.13.	Сероводород	0,01	моль, %
1.14.	Кислород	0,07	моль, %
2	Абсолютная влажность	7,42	г/м ³
3	Температура газа	10	°C
4	Давление газа	0,7	МПа

Таблица 5 – исходные данные для метода по ГОСТ 30319.3-2015

№	Параметр	Показатели	Единицы измерения
1	Метан	86,43	моль,%
2	Этан	1,8	моль,%
3	Пропан	0,45	моль,%
4	И-бутан	0,1	моль,%
5	Н-бутан	0,1	моль,%
6	И-пентан	0,03	моль,%
7	Н-пентан	0,05	моль,%
8	Н-гексан	0,1	моль,%
9	Азот	0,34	моль,%

№	Параметр	Показатели	Единицы измерения
10	Диоксид углерода	0,6	МОЛЬ,%
11	Гелий	0,5	МОЛЬ,%
12	Водород	9,5	МОЛЬ,%

Таблица 5 (введена дополнительно, Изм. № 2)

6.4.5.4 Измерения проводят в трех точках в соответствии с таблицей 5.

Таблица 6 – точки давления и температуры

№ измерения	Значение давления, МПа	Значение температуры, К
1	P_{\min}^*	333,15
2	$(P_{\max} + P_{\min})/2$	293,15
3	P_{\max}	253,15 (263,15)**

* Если нижний предел (P_{\min}) применяемого преобразователя давления ниже 0,1 МПа, то при определении относительной погрешности приведения рабочего объема газа к стандартным условиям $P_{\min}=0,1$ МПа

** значение температуры 263,15К выбирается для метода расчета коэффициента сжимаемости ГСССД МР 113–03

Примечание – P_{\min} и P_{\max} нижний и верхний пределы диапазоны измерения соответственно, приведенные в паспорте.

Таблица 5 (Измененная редакция, Изм. № 2)

6.4.5.5 В каждой точке проводят по одному измерению корректирующего коэффициента (K_{kor}) и определяют относительную погрешность при приведении объема газа, к стандартным условиям, в диапазоне изменения параметров газа, с учетом погрешности измерения давления, температуры и вычисления коэффициента сжимаемости по формуле

$$\delta_K = \frac{K_{kor} - K_{kor;ET}}{K_{kor;ET}} \cdot 100\% \quad (6)$$

где K_{kor} – корректирующий коэффициент, вычисленный корректором

$K_{kor;ET}$ – эталонный корректирующий коэффициент. Значения корректирующего коэффициента приведены в приложении А.

6.4.5.6 Значения эталонного корректирующего коэффициента рассчитываются по формуле

$$K_{kor;ET} = \frac{P \cdot T_c}{P_c \cdot T \cdot K} \quad (7)$$

где P – измеренное значение абсолютного давления, МПа

T – измеренное значение температуры, К

P_c – значение абсолютного давления при стандартных условиях, МПа (0,101325 МПа)

T_c – значение температуры при стандартных условиях, К (293,15К)

K – коэффициент сжимаемости газа, рассчитанный в соответствии с выбранным методом расчета

6.4.5.7 Результат поверки считают положительным, если рассчитанные значения относительной погрешности при приведении объема газа, к стандартным условиям, в диапазоне изменения параметров газа, с учетом погрешности измерения давления, температуры и вычисления коэффициента сжимаемости не превышают 0,37 %.

7 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

7.1 Результаты поверки оформляют протоколом, рекомендуемая форма которого приведена в приложениях Б, В

7.2 При положительных результатах поверки делают оттиск знака поверки в паспорте и оттиск давлением на пломбы и специальную мастику (термопластичную массу) в соответствии с описанием типа средств измерений и приказом Минпромторга России №1815 от 2 июля 2015 г. «Об утверждении Порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке».

7.3 При отрицательных результатах поверки выдают извещение о непригодности к применению с указанием причин в соответствии с приказом Минпромторга России №1815 от 2 июля 2015 г. «Об утверждении Порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке».

7.2, 7.3 (Измененная редакция, Изм. № 1)

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Таблицы коэффициентов коррекции для методов NX19 mod., Gerg-91 по ГОСТ 30319.2-96 (Исключено, Изм. № 1)

А.1 Коэффициенты коррекции для метода по ГОСТ 30319.2-2015

Таблица А.1.1 – Исходные данные для расчета коэффициентов коррекции для метода по ГОСТ 30319.2-2015

Наименование	Значение
Содержание СО ₂ , %	0
Содержание N ₂ , %	0,65
Плотность среды при стандартных условиях, кг/м ³	0,6714

Таблица А.1.2 – Коэффициенты коррекции для метода по ГОСТ 30319.2-2015

Р, бар	Р, МПа	T, K	Эталонный коэффициент сжимаемости K	Эталонный коэффициент коррекции K.Kор
1	0,1		1,00076	0,867767798
1,5	0,15		1,00019	1,302393498
2	0,2		0,99963	1,737492264
4	0,4		0,99740	3,482774871
7	0,7		0,99407	6,115266877
10	1		0,99077	8,76517559
12	1,2	333,15	0,98859	10,54140505
14	1,4		0,98643	12,32529815
15	1,5		0,98535	13,22011059
22	2,2		0,97792	19,53677258
28	2,8		0,97172	25,02376155
40	4		0,95980	36,19216175
1,4	0,14		0,99933	1,382624462
2	0,2		0,99823	1,977344456
3	0,3		0,99641	2,971443224
4,5	0,45		0,99368	4,46941481
5,4	0,54		0,99204	5,372142523
5,5	0,55		0,99186	5,472630653
6	0,6		0,99095	5,975612922
11	1,1		0,98190	11,05630828
12	1,2	293,15	0,98009	12,08362798
21	2,1		0,96398	21,49976722
24,5	2,45		0,95778	25,24537895
38,5	3,85		0,93348	40,7044064
49	4,9		0,91588	52,80073205
55	5,5		0,90614	59,9036343
66	6,6		0,88896	73,27310827
70	7		0,88297	78,24128443
2	0,2	253,15	0,99589	2,295163044

P, бар	P, МПа	T, К	Эталонный коэффициент сжимаемости K	Эталонный коэффициент коррекции K.Kор
5	0,5		0,98687	5,790363815
7,5	0,75		0,97932	8,752506407
10	1		0,97174	11,76101564
20	2		0,94117	24,2861234
35	3,5		0,89469	44,70847379
55	5,5		0,83252	75,50267263
70	7		0,78725	101,6208754

Таблица А.1, А.2 (Введены дополнительно, Изм. № 1)

А.2 Коэффициенты коррекции для метода ГСССД МР 113–03

Таблица А.2.1 – Исходные данные для расчета коэффициентов коррекции для метода ГСССД МР 113–03

Наименование показателей	Значения показателей
Метан, моль, %	72,5
Этан, моль, %	14,3
Пропан, моль, %	7,53
И-бутан, моль, %	0,85
Н-бутан, моль, %	1,57
И-пентан, моль, %	0,29
Н-пентан, моль, %	0,25
Гексан, моль, %	0,12
Гептан, моль, %	0,02
Азот, моль, %	0,93
Диоксид углерода, моль, %	1,56
Сероводород, моль, %	0,01
Кислород, моль, %	0,07
Абсолютная влажность, г/м ³	7,42
Температура газа при определении влажности, °C	10
Давление газа при определении влажности, МПа	0,7

Таблица А.2.2 – Коэффициенты коррекции для метода ГСССД МР 113–03

P, бар	P, МПа	T, К	Эталонный коэффициент сжимаемости K	Эталонный коэффициент коррекции K.Kор
1	0,1		1,00132	0,867282489
1,5	0,15		1,00015	1,302445586
2	0,2	333,15	0,998973	1,738640187
4	0,4		0,994283	3,493682591
7	0,7		0,987268	6,157386964

P, бар	P, МПа	T, К	Эталонный коэффициент сжимаемости K	Эталонный коэффициент коррекции K.Kор
10	1		0,980269	8,859071356
12	1,2		0,975611	10,68164219
14	1,4		0,97096	12,52160977
15	1,5		0,968637	13,44818495
22	2,2		0,952427	20,05970079
28	2,8		0,938619	25,90610722
40	4		0,911339	38,11654289
1,4	0,14		0,998598	1,383632426
2	0,2		0,996422	1,980934316
3	0,3		0,992795	2,982256962
4,5	0,45		0,987347	4,498068764
5,4	0,54		0,984073	5,415640547
5,5	0,55		0,983709	5,517971236
6	0,6		0,981887	6,030775028
11	1,1		0,963574	11,26655133
12	1,2	293,15	0,959888	12,33798026
21	2,1		0,926348	22,37322108
24,5	2,45		0,913119	26,4802507
38,5	3,85		0,859205	44,22291044
49	4,9		0,817931	59,12386261
55	5,5		0,794201	68,34640056
66	6,6		0,750994	86,73429562
70	7		0,735587	93,9176857
82,5	8,25		0,68983	118,030775
2	0,2		0,993439	2,213393866
5	0,5		0,977963	5,621050564
7,5	0,75		0,964899	8,545732982
10	1		0,95166	11,55282238
20	2		0,896678	24,52242376
35	3,5	263,15	0,806636	47,70461064
55	5,5		0,667489	90,59171641
70	7		0,54987	139,9612865
100	10		0,438795	250,5579814
120	12		0,458788	287,5670404
150	15		0,515479	319,9264843

A.3 Коэффициенты коррекции для метода по ГОСТ 30319.3-2015

Таблица А.3.1 – Исходные данные для расчета коэффициентов коррекции для метода по ГОСТ 30319.2-2015

Наименование показателей	Значения показателей
Метан, моль,%	86,43
Этан, моль,%	1,8

Пропан, моль,%	0,45
И-бутан, моль,%	0,1
Н-бутан, моль,%	0,1
И-пентан, моль,%	0,03
Н-пентан, моль,%	0,05
Н-гексан, моль,%	0,1
Азот, моль,%	0,34
Диоксид углерода, моль,%	0,6
Гелий, моль,%	0,5
Водород, моль,%	9,5

Таблица А.3.2 – Коэффициенты коррекции для метода по ГОСТ 30319.3-2015

P, бар	P, МПа	T, К	Эталонный коэффициент сжимаемости K	Эталонный коэффициент коррекции K.Кор
1	0,1		1,000662061	0,867853
1,5	0,15		1,000191307	1,302390
2	0,2		0,999721554	1,737340
4	0,4		0,997850554	3,481190
7	0,7		0,995071099	6,109100
10	1		0,992325698	8,751430
12	1,2		0,990512792	10,520900
14	1,4	333,15	0,988716913	12,296700
15	1,5		0,987824483	13,187000
22	2,2		0,98169065	19,461700
28	2,8		0,976597486	24,898600
40	4		0,974935822	26,722600
50	5		0,966904949	35,926100
80	8		0,959370872	45,260200
100	10		0,940155069	73,896500
1,4	0,14		0,999387017	0,867853
2	0,2		0,998438497	1,302390
3	0,3		0,996858965	1,737340
4,5	0,45		0,994495176	3,481190
5,4	0,54		0,993079907	6,109100
5,5	0,55		0,992922655	8,751430
6	0,6		0,992137396	10,520900
11	1,1		0,984330882	12,296700
12	1,2		0,982779395	13,187000
21	2,1	293,15	0,968985283	19,461700
24,5	2,45		0,963709827	24,898600
38,5	3,85		0,943208964	26,722600
49	4,9		0,928580515	35,926100
55	5,5		0,92056166	45,260200
66	6,6		0,907823241	73,896500
70	7		0,906596274	93,325200
82,5	8,25		0,901777549	76,609300
105	10,5		0,887721017	91,719200
165	16,5		0,866784455	119,553000

P, бар	P, МПа	T, K	Эталонный коэффициент сжимаемости K	Эталонный коэффициент коррекции K.Kор
200	20		0,84387373	192,970000
2	0,2		0,996257	2,294320
5	0,5		0,98822212	5,782430
7,5	0,75		0,981518374	8,732890
10	1		0,974808618	11,724000
20	2		0,94794155	24,112600
35	3,5		0,907815228	44,062200
55	5,5		0,855744759	73,453700
70	7	263,15	0,819117045	97,666800
100	10		0,758493866	150,676000
120	12		0,732356968	187,264000
150	15		0,71842163	238,620000
160	16		0,719848918	254,023000
250	25		0,809543699	352,935000
300	30		0,885608631	387,146000

Пункт A3 (Введен дополнительно, Изм. № 2)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(рекомендуемое)
Протокол поверки корректора газа потокового ЕК280

Протокол поверки №_____

Наименование СИ:

Тип, исполнение:

Заводской номер:

Дата проведения поверки:

Условия проведения поверки:

- температура окружающей среды, °С

- относительная влажность, %

- атмосферное давление, кПа

1. Проведение внешнего осмотра по пункту 6.1 методики поверки.

Пункт методики	Описание требований	Соответствие требованиям	
		Да	Нет
6.1.1	Комплектность должна соответствовать указанной в паспорте		
6.1.1	Маркировка должна быть четко обозначена		
6.1.1	Не должно быть механических повреждений, которые могли бы повлиять на работу корректора		

2. Проверка идентификации программного обеспечения по пункту 6.2 методики поверки.

Пункт методики	Описание требований	Соответствие требованиям	
		Да	Нет
6.2	Версия ПО (метрологически значимая часть) должна быть 1.10		
6.2	Контрольная сумма версии ПО (метрологически значимой части) должна быть 57586		

(Измененная редакция, Изм. №2)

3. Проведение опробования корректора газа потокового по пункту 6.3 методики поверки.

Пункт методики	Описание требований	Необходимые действия	Соответствие требований	
			Да	Нет
1	При опробовании проверить общее функционирование и работоспособность корректора в соответствии с эксплуатационной документацией	С клавиатуры корректора выбрать пункт проверки ЖКИ в списке «Сервис», задействуются все сегменты ЖКИ		
3	Проверить все исходные данные, занесенные в память корректора, указанные в паспорте	Последовательно вызывать параметры из памяти корректора, выбирая их в меню, и сравнить из значения со значениями из паспорта. Выполнение проверки также возможно с использованием ПК с установленным ПО WinPADs или EnSuite		
4	Произвести проверку работы корректора, при измерении им объема газа без коррекции по формуле $V=N/Cp$ где: N - число импульсов, приходящих на корректор от счетчика газа; Cp - коэффициент преобразования счетчика газа, имп./м ³ равный 1 (или согласно коэффициенту преобразования счетчика газа)	Перед подачей импульсов с генератора, обнулить показания счетчика рабочего объема введя Vp=0. Дважды подать с генератора на корректор: а) 20 импульсов при Cp > 1, б) 5 импульсов при Cp ≤ 1 Для проверки ВЧ входа подать не менее 2500 импульсов частотой 500 Гц Убедиться, что все импульсы прошли на корректор без потерь		

(Измененная редакция, Изм. №2)

4. Проведение поверки канала измерения абсолютного давления корректора газа по пункту 6.4.1 методики поверки

Корректор № _____ Диапазон: Рмин.= _____ Рмакс.= _____ $P_0 = \frac{P_{\max} - P_{\min}}{4} = _____$ МПа/бар Преобразователь давления № _____			Ответственный за поверку: Давление атмосферное: Ратм. [МПа]- _____ [мм.рт.ст.]- _____ Температура окр. среды: _____ °C Ответственный за приемку:		
Прямой ход	P _{мин.}	P _{мин.} +P ₀	P _{мин.} +2P ₀	P _{мин.} +3P ₀	P _{макс.}
P ₃ [МПа/бар]					
P [МПа/бар]					
Относительная погрешность δ _p , %					
Обратный ход	P _{макс.}	P _{мин.} +3P ₀	P _{мин.} +2P ₀	P _{мин.} +P ₀	P _{мин.}
P ₃ [МПа/бар]					
P [МПа/бар]					
Относительная погрешность δ _p , %					

5 Проведение поверки дополнительного канала измерения абсолютного давления №_____ по пункту 6.4.1 методики поверки (оформляется на каждый подключенный дополнительный преобразователь абсолютного давления)

Диапазон: Рмин.= _____ Рмакс.= _____ $P_0 = \frac{P_{\max} - P_{\min}}{4} = _____$ МПа/бар Преобразователь давления № _____			Давление атмосферное: Ратм. [МПа]- _____ [мм.рт.ст.]- _____ Температура окр. среды: _____ °C Ответственный за приемку:		
Прямой ход	P _{мин.}	P _{мин.} +P ₀	P _{мин.} +2P ₀	P _{мин.} +3P ₀	P _{макс.}
P ₃ [МПа/бар]					
P [МПа/бар]					
Относительная погрешность δ _p , %					
Обратный ход	P _{макс.}	P _{мин.} +3P ₀	P _{мин.} +2P ₀	P _{мин.} +P ₀	P _{мин.}
P ₃ [МПа/бар]					
P [МПа/бар]					
Относительная погрешность δ _p , %					

6 Проведение поверки дополнительного канала измерения избыточного давления №_____ по пункту 6.4.2 методики поверки (оформляется на каждый подключенный дополнительный преобразователь избыточного давления)

Диапазон: Рмин.= _____ Рмакс.= _____ $P_0 = \frac{P_{\max} - P_{\min}}{4} = _____$ МПа/бар Преобразователь давления № _____			Давление атмосферное: Ратм. [МПа]- _____ [мм.рт.ст.]- _____ Температура окр. среды: _____ °C Ответственный за приемку:		
Прямой ход	P _{мин.}	P _{мин.} +P ₀	P _{мин.} +2P ₀	P _{мин.} +3P ₀	P _{макс.}
P ₃ [МПа/бар]					
P [МПа/бар]					
Приведённая погрешность γ _p , %					
Обратный ход	P _{макс.}	P _{мин.} +3P ₀	P _{мин.} +2P ₀	P _{мин.} +P ₀	P _{мин.}
P ₃ [МПа/бар]					
P [МПа/бар]					
Приведённая погрешность γ _p , %					

(Измененная редакция, Изм. № 2)

7 Проведение поверки канала измерения перепада давления № по пункту 6.4.3 методики поверки (оформляется на каждый подключенный дополнительный преобразователь избыточного давления)

Диапазон: Рмин.= _____ Рмакс.= _____	Предварительное значение атмосферного давления № _____	Давление атмосферное: Ратм. [МПа]- _____ [мм.рт.ст.]- _____
Ответственный за приемку:		Температура окр. среды: _____ °C
Прямой ход	P1	P2
P ₃ [Па]		
P [Па]		
Основная приведенная погрешность γ _p , %		
Обратный ход	P3	P2
P ₃ [Па]		
P [Па]		
Основная приведенная погрешность γ _p , %		

8 Проведение поверки канала измерения температуры по пункту 6.4.4 методики поверки.

Тип преобразователя: Pt 500(500П) Преобразователь температуры 1 № _____	Температура окруж. среды: Погрешность δt ₅₀₀ Ответственный за поверку:
	-30 °C/-40 °C* (243.15 K) / (233.15 K)*
T _z - температура задаваемая	20 °C (293.15 K)
T - температура измеренная	
Относительная погрешность δt, %	60 °C (333.15 K)

9 Проведение поверки дополнительного канала измерения температуры № по пункту 6.4.4 методики поверки (оформляется на каждый подключенный дополнительный преобразователь температуры)

Тип преобразователя: Pt 500(500П) Преобразователь температуры 2 № _____	Температура окруж. среды: Погрешность δt ₅₀₀ Ответственный за поверку:
	-30 °C/-40 °C* (243.15 K) / (233.15 K)*
T _z - температура задаваемая	20 °C (293.15 K)
T - температура измеренная	
Относительная погрешность δt, %	60 °C (333.15 K)

10 Определение относительной погрешности приведения объёма, к стандартным условиям для диапазона давлений _____ бар по пункту методики 6.4.5.

Корректор № _____				Ратм. [МПа] 0,099 To - 293.15 [K] Po - 0,101325 МПа (1.01325 Бар)		
Ответственный за поверку:						
№ изм.	P _[бар.абс]	T, [K]	K	K _{кор.}	K _{кор.ЭТ}	δ _{Kкор.} , [%]
1						
2						
3						

Подпись _____ Ф.И.О. _____ Дата _____
(Измененная редакция, Изм. № 1)

ПРИЛОЖЕНИЕ В
(рекомендуемое)

Протоколы поверки корректора газа потокового ЕК290

Протокол поверки №_____

Наименование СИ:

Тип, исполнение:

Заводской номер:

Дата проведения поверки:

Условия проведения поверки:

- температура окружающей среды, °С

- относительная влажность, %

- атмосферное давление, кПа

1 Проведение внешнего осмотра по пункту 6.1 методики поверки

Пункт методики	Описание требований	Соответствие требованиям	
		Да	Нет
6.1.1	Комплектность должна соответствовать указанной в паспорте		
6.1.1	Маркировка должна быть четко обозначена		
6.1.1	Не должно быть механических повреждений, которые могли бы повлиять на работу корректора		

2 Проведение проверки идентификации программного обеспечения по пункту 6.2 методики поверки

Пункт методики	Описание требований	Соответствие требованиям	
		Да	Нет
6.2	Версия ПО (метрологически значимая часть) должна быть 1.10		
6.2	Контрольная сумма версии ПО (метрологически значимой части) должна быть 57586		

(Измененная редакция, Изм. № 2)

3 Проведение опробования корректора газа потокового по пункту 6.3 методики поверки

Пункт методики	Описание требований	Необходимые действия	Соответствие требований	
			Да	Нет
1	При опробовании проверить общее функционирование и работоспособность корректора в соответствии с эксплуатационной документацией	С клавиатуры корректора выбрать пункт проверки ЖКИ в списке «Сервис», задействуются все сегменты ЖКИ		
3	Проверить все исходные данные, занесенные в память корректора, указанные в паспорте	Последовательно вызывать параметры из памяти корректора, выбирая их в меню, и сравнить из значения со значениями из паспорта. Выполнение проверки также возможно с использованием ПК с установленным ПО WinPADs или EnSuite		
4	Произвести проверку работы корректора, при измерении им объема газа без коррекции по формуле $V=N/Cp$ где: N - число импульсов, приходящих на корректор от счетчика газа; Cp - коэффициент преобразования счетчика газа, имп./м ³ равный 1 (или согласно коэффициенту преобразования счетчика газа).	Перед подачей импульсов с генератора, обнулить показания счетчика рабочего объема введя Vp=0. Дважды подать с генератора на корректор: а) 20 импульсов при Cp >1, б) 5 импульсов при Cp ≤1 Для проверки ВЧ входа подать не менее 2500 импульсов частотой 500 Гц Убедиться, что все импульсы прошли на корректор без потерь		

(Измененная редакция, Изм. № 2)

4 Проведение поверки канала измерения абсолютного давления №1 (используется для вычисления коэффициента коррекции первого канала) по пункту 6.4.1 методики поверки.

Диапазон: Рмин.= _____ Рмакс.= _____ $P_0 = \frac{P_{\max} - P_{\min}}{4} = \text{_____ МПа/бар}$ Преобразователь давления № _____			Давление атмосферное: Ратм. [МПа]- _____ [мм.рт.ст.]- _____ Температура окр. среды: _____ °C Ответственный за приемку:		
Прямой ход	P _{мин.}	P _{мин.+Po}	P _{мин.+2Po}	P _{мин.+3Po}	P _{макс.}
P ₃ [МПа/бар]					
P [МПа/бар]					
Относительная погрешность δ _p , %					
Обратный ход	P _{макс.}	P _{мин.+3Po}	P _{мин.+2Po}	P _{мин.+Po}	P _{мин.}
P ₃ [МПа/бар]					
P [МПа/бар]					
Относительная погрешность δ _p , %					

5 Проведение поверки канала измерения абсолютного давления №2 корректора газа (используется для вычисления коэффициента коррекции для второго канала) по пункту 6.4.1 методики поверки.

Диапазон: Рмин.= _____ Рмакс.= _____ $P_0 = \frac{P_{\max} - P_{\min}}{4} = \text{_____ МПа/бар}$ Преобразователь давления № _____			Давление атмосферное: Ратм. [МПа]- _____ [мм.рт.ст.]- _____ Температура окр. среды: _____ °C Ответственный за приемку:		
Прямой ход	P _{мин.}	P _{мин.+Po}	P _{мин.+2Po}	P _{мин.+3Po}	P _{макс.}
P ₃ [МПа/бар]					
P [МПа/бар]					
Относительная погрешность δ _p , %					
Обратный ход	P _{макс.}	P _{мин.+3Po}	P _{мин.+2Po}	P _{мин.+Po}	P _{мин.}
P ₃ [МПа/бар]					
P [МПа/бар]					
Относительная погрешность δ _p , %					

6 Проведение поверки дополнительного канала измерения абсолютного давления № _____ по пункту 6.4.1 методики поверки (оформляется на каждый подключенный дополнительный преобразователь абсолютного давления)

Диапазон: Рмин.= _____ Рмакс.= _____ $P_0 = \frac{P_{\max} - P_{\min}}{4} = \text{_____ МПа/бар}$ Преобразователь давления № _____			Давление атмосферное: Ратм. [МПа]- _____ [мм.рт.ст.]- _____ Температура окр. среды: _____ °C Ответственный за приемку:		
Прямой ход	P _{мин.}	P _{мин.+Po}	P _{мин.+2Po}	P _{мин.+3Po}	P _{макс.}
P ₃ [МПа/бар]					
P [МПа/бар]					
Относительная погрешность δ _p , %					
Обратный ход	P _{макс.}	P _{мин.+3Po}	P _{мин.+2Po}	P _{мин.+Po}	P _{мин.}
P ₃ [МПа/бар]					
P [МПа/бар]					
Относительная погрешность δ _p , %					

7 Проведение поверки дополнительного канала измерения избыточного давления № по пункту 6.4.2 методики поверки (оформляется на каждый подключенный дополнительный преобразователь избыточного давления)

Диапазон: Рмин.= _____ Рмакс.= _____ $P_0 = \frac{P_{\max} - P_{\min}}{4}$ = _____ МПа/бар Преобразователь давления №			Давление атмосферное: Ратм. [МПа]- _____ [мм.рт.ст.]- _____ Температура окр. среды: _____ °C Ответственный за приемку:		
Прямой ход	P _{мин.}	P _{мин.+Po}	P _{мин.+2Po}	P _{мин.+3Po}	P _{макс.}
P ₃ [МПа/бар]					
P [МПа/бар]					
Приведённая погрешность γ _п , %					
Обратный ход	P _{макс.}	P _{мин.+3Po}	P _{мин.+2Po}	P _{мин.+Po}	P _{мин.}
P ₃ [МПа/бар]					
P [МПа/бар]					
Приведённая погрешность γ _п , %					

(Измененная редакция, Изм. № 2)

8 Проведение поверки канала измерения перепада давления № по пункту 6.4.3 методики поверки (оформляется на каждый подключенный дополнительный преобразователь избыточного давления)

Диапазон: Рмин.= _____ Рмакс.= _____ Преобразователь перепада давления № Ответственный за приемку:		Давление атмосферное: Ратм. [МПа]- _____ [мм рт.ст.]- _____ Температура окр. среды: _____ °C	
Прямой ход	P1	P2	P3
P ₃ [Па]			
P [Па]			
Основная приведенная погрешность γ _п , %			
Обратный ход	P3	P2	P1
P ₃ [Па]			
P [Па]			
Основная приведенная погрешность γ _п , %			

9 Проведение поверки канала измерения температуры №1 корректора газа (используется для вычисления коэффициента коррекции) по пункту 6.4.4 методики поверки

Тип преобразователя: Pt 500(500П) Преобразователь температуры 1 №		Температура окруж. среды: Погрешность δt ₅₀₀ Ответственный за поверку:	
	-30 °C/-40 °C* (243.15 K) / (233.15)*	20 °C (293.15 K)	60 °C (333.15 K)
Тз - температура задаваемая			
Т - температура измеренная			
Относительная погрешность δt, %			

10 Проведение поверки канала измерения температуры №2 корректора газа (используется для вычисления коэффициента коррекции) по пункту 6.4.4 методики поверки

Тип преобразователя: Pt 500(500П) Преобразователь температуры 1 №		Температура окруж. среды: Погрешность δt ₅₀₀ Ответственный за поверку:	
	-30 °C/-40 °C* (243.15 K) / (233.15)*	20 °C (293.15 K)	60 °C (333.15 K)
Тз - температура задаваемая			
Т - температура измеренная			
Относительная погрешность δt, %			

11 Проведение поверки дополнительного канала измерения температуры № по пункту 6.4.4 методики поверки (оформляется на каждый подключенный дополнительный преобразователь температуры)

Тип преобразователя: Pt 500(500П) Преобразователь температуры 2 №	Температура окруж. среды: Погрешность δ_{Pt500} Ответственный за поверку:
	-30 °C/-40 °C* (243.15 K) / (233.15 K)*
20 °C (293.15 K)	60 °C (333.15 K)
T _z - температура задаваемая	
T - температура измеренная	
Относительная погрешность δ_t , %	

12 Определение относительной погрешности приведения объёма, к стандартным условиям канала 1 для диапазона давлений _____ бар по пункту методики 6.4.5

Корректор № _____				Ратм. [МПа] 0,099 To - 293.15 [K] Po - 0,101325 МПа (1.01325 Бар)		
Ответственный за поверку:						
№ изм.	P _[бар.абс]	T, [K]	K	K _{кор.}	K _{кор ЭТ}	$\delta_{K\text{кор.}} [\%]$
1						
2						
3						

13 Определение относительной погрешности приведения объёма, к стандартным условиям канала 2 для диапазона давлений _____ бар по пункту методики 6.4.5

Корректор № _____				Ратм. [МПа] 0,099 To - 293.15 [K] Po - 0,101325 МПа (1.01325 Бар)		
Ответственный за поверку:						
№ изм.	P _[бар.абс]	T, [K]	K	K _{кор.}	K _{кор ЭТ}	$\delta_{K\text{кор.}} [\%]$
1						
2						
3						

Подпись _____ Ф.И.О. _____ Дата _____
(Измененная редакция, Изм. № 1)